

UMA CO., LTD.

2-19-6 Yokosuka

Matsudo, Chiba, Japan



MEASURE CRP

Thuốc thử định lượng C-reactive protein

Phương pháp Latex miễn dịch độ dộ

① 2 - 8°C

IVD Chẩn đoán *In vitro*

※ KHÔNG đông đá

② 12 tháng/tránh ánh sáng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (BỘI TUV)

ISO 13485:2016

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Xét nghiệm định lượng nồng độ C-reactive protein (CRP) trong huyết thanh hoặc huyết tương.

2. GIỚI THIỆU CHUNG

- Chi sử dụng cho chẩn đoán *In vitro*
- Chẩn đoán phải được thực hiện một cách toàn diện bằng cách kết hợp kết quả xét nghiệm với triệu chứng lâm sàng và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.
- Việc sử dụng sản phẩm này phải tuân theo hướng dẫn sử dụng đi kèm để đảm bảo kết quả chính xác.
- Nếu sử dụng máy phân tích tự động, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng.

TÓM TẮT CƠ BẢN

Xơ vữa động mạch là một tình trạng viêm mãn tính được kích hoạt bởi sự thay đổi oxy hóa ban đầu của lipoprotein trong không gian động mạch. Protein phản ứng C (CRP) là một dấu ấn sinh học protein gây viêm được cho là để dự đoán nguy cơ bệnh tim mạch. Mặc dù tương đối ít nghiên cứu lâm sàng đã kiểm tra tình trạng viêm phản ứng với việc tiêu thụ sterol thực vật, nhưng phần lớn các nghiên cứu này đã không nhận thấy tác động của liệu pháp sterol thực vật đối với nồng độ CRP và các dấu hiệu cấp tính khác của viêm toàn thân bao gồm cả yếu tố hoại tử khối u alpha (TNF- α) và interleukin-6 (IL-6).

3. VẬT LIỆU YÊU CẦU NHƯNG KHÔNG BAO GỒM

- Nước muối sinh lý 0.9% hoặc nước cất pha tiêm.
- Micropipet và dụng cụ phòng thí nghiệm cơ bản khác.
- CRP Calibrator Set và CRP Control Set.

4. THÀNH PHẦN THUỐC THỬ VÀ CHUẨN BỊ

- Thuốc thử R-1: Saline Buffer

Thuốc thử R-1 sẵn sàng để sử dụng.

- Thuốc thử R-2: anti-human CRP rabbit antibody-sensitized latex

Thuốc thử R-2 sẵn sàng để sử dụng

- Sau khi mở, Thuốc thử được lưu trữ trên thiết bị sấy ổn định trong 30 ngày với Máy phân tích Hitachi 7180.

- Sử dụng cho các máy phân tích tự động khác nhau.

- Chất chuẩn (bản riêng): Sẵn sàng để sử dụng

- Vật liệu kiểm soát mức thấp & Cao (bản riêng): Sẵn sàng để sử dụng.

5. CHUẨN BỊ VÀ BẢO QUẢN MẪU

- Huyết thanh: Chờ cho đến khi mẫu đông tự hoàn toàn. Lấy phần nổi phía trên để làm bệnh phẩm

- Huyết tương: Xử lý mẫu máu bằng chất chống đông (huyết tương Li-heparin và K2-EDTA); để yên trong 3 giờ hoặc ly tâm với tốc độ 2000 vòng/phút trong 2 phút; lấy lớp huyết tương (phần nổi phía trên) và dùng làm bệnh phẩm.

- Phân tích mẫu ngay sau khi thu thập. Trong trường hợp bảo quản mẫu 2 - 8°C, phân tích trong vòng 3 ngày.

- Độ ổn định:

- 8 giờ ở 15 - 25°C

- 3 ngày ở 2 - 8°C

- 6 tháng ở <-20°C

- Tham khảo mục yếu tố ảnh hưởng để biết thêm thông tin về khả năng gây nhiễu mẫu.


6. NGUYÊN LÝ ĐO

Khi thuốc thử latex được tạo ra để phản ứng với mẫu vật, CRP trong mẫu bệnh phẩm và latex nhạy cảm với kháng thể kháng CRP của thỏ trong thuốc thử latex tạo ra phản ứng kháng nguyên-kháng thể cụ thể, dẫn đến đặc.

Vì mức độ đặc tỷ lệ với nồng độ CRP trong mẫu vật, độ đặc được đo bằng quang học để xác định nồng độ CRP.

7. QUY TRÌNH TIỀN HÀNH

Sản phẩm tương thích với nhiều dòng máy xét nghiệm tự động khác nhau. Dưới đây là quy trình tham khảo.

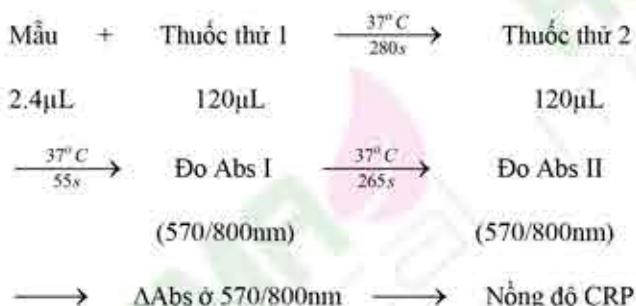

Quy trình tiền hành được xây dựng trên dòng máy xét nghiệm sinh hóa tự động Hitachi. Tham khảo mục 13. **THÔNG SỐ CÀI ĐẶT CHO MÁY TỰ ĐỘNG** những thông số cài đặt trên máy. Liên hệ Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Huma Medical cho quy trình tiền hành trên những dòng máy khác.

8. TÍNH TOÁN VÀ CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ

Tính toán

- Tính ΔAbs của mẫu và tiêu chuẩn so với mẫu trắng
- Vẽ đường chuẩn CRP = $f(\Delta\text{Abs})$
- Tính nồng độ CRP trong bệnh phẩm bằng cách sử dụng đường chuẩn (thực hiện quy trình tương tự đối với vật liệu kiểm soát)

Chuyển đổi đơn vị

$$\text{mg/dL} \times 10 = \text{mg/L}$$

9. HIỆU NĂNG VÀ TƯƠNG QUAN

a. Khoảng đo

- Kết quả xét nghiệm tuyển tuyển tính trong phạm vi nồng độ CRP từ 0.1 - 320 mg/L.
- Nếu nồng độ của mẫu vượt quá phạm vi xét nghiệm, pha loãng mẫu bằng nước muối và lặp lại phép đo.

b. Giới hạn phát hiện

Limit of Blank (LoB)	=	0.0 mg/L
Limit of Detection (LoD)	=	0.1 mg/L
Limit of Quantitation (LoQ)	=	0.1 mg/L

Giá trị LoB, LoD, LoQ được xác định dựa theo tiêu chuẩn EP17-A2 của CLSI.

Giá trị LoB là nồng độ chất phân tích cao nhất dự kiến được tìm thấy khi chạy lặp lại mẫu trắng. LoB tương ứng với nồng độ mà dưới giá trị đó xác suất phát hiện mẫu trắng là 95%.

Giá trị LoD xác định dựa trên LoB và độ lệch chuẩn của mẫu nồng độ thấp. LoD tương ứng với nồng độ thấp nhất chất phân tích có thể được phát hiện (giá trị nồng độ cao hơn LoB với xác suất 95%).

Giá trị LoQ là giá trị nồng độ thấp nhất có thể do lường được với sai số toàn phần cho phép là 20%. LoQ được xác định bằng cách chạy mẫu nồng độ thấp.

c. Hiệu năng

- Độ nhạy: Sử dụng nước cất, sự thay đổi độ hấp thụ nhỏ hơn 0.015; sử dụng dung dịch mẫu CRP 10 mg/L, sự thay đổi độ hấp thụ từ 0.02 - 0.12.

- Độ chính xác: khi đo mẫu kiểm soát, kết quả chênh lệch trong khoảng $\pm 10\%$ so với giá trị gần.

d. Độ chụm (trên máy Biolis 30i / SK300)

Dữ liệu hiệu năng về độ chụm đại diện cho hệ máy/dòng máy được đưa ra dưới đây.

Kết quả có thể khác nhau giữa các phòng xét nghiệm.

Độ chụm được tính toán sử dụng mẫu vật liệu kiểm soát tuân theo tiêu chuẩn được áp dụng của CLSI EP5-A2 với độ lặp lại, độ tái lặp và độ chụm toàn phần (sử dụng 1 mẫu trong 1 lần chạy, 2 lần chạy trong ngày và chạy trong vòng 20 ngày). Kết quả thu được như dưới đây.

Tiêu chí: Độ lặp lại (CV Within-run precision) nhỏ hơn 2% và Độ chụm toàn phần (CV Total precision) nhỏ hơn 5%.

Độ lặp lại	Mean mg/L	SD mg/L	CV %
CRP Control Low	11.3	0.12	1.04
CRP Control High	27.6	0.20	0.71

Độ tái lặp	Mean mg/L	SD mg/L	CV %
CRP Control Low	11.3	0.31	2.78
CRP Control High	27.6	0.67	2.44

Dộ đậm toàn phần	Mean mg/L	SD mg/L	CV %
CRP Control Low	11.3	0.32	2.87
CRP Control High	27.6	0.69	2.49

Tài liệu tham khảo để hiệu chuẩn

IRMM ERM-DA474/IFCC

10. GIÁ TRỊ THAM CHIẾU

Nhỏ hơn 3 mg/L

Phạm vi tham chiếu phải được thiết lập riêng cho mỗi cơ sở xét nghiệm dựa trên sự đánh giá toàn diện của các kết quả xét nghiệm và triệu chứng lâm sàng, các kết quả đo khác cũng như đặc điểm sinh học dân cư khu vực đó.

11. YÊU TỐ ÁNH HƯỚNG

- Hội chứng vàng da: Nồng độ bilirubin liên hợp và bilirubin tự do lên đến 20 mg/dL không ảnh hưởng đáng kể.
- Tán huyết: Không có sự ảnh hưởng đáng kể của nồng độ hemoglobin lên đến 500 mg/dL.
- Lipid huyết (Intralipid): Nồng độ triglycerid không gây nhiễu đáng kể lên đến 3000 FTU.
- Acid ascorbic: Nồng độ acid ascorbic lên đến 50 mg/dL không ảnh hưởng tới kết quả.
- Đối với mục đích chẩn đoán, kết quả phải luôn được đánh giá cùng với bệnh sử, khám lâm sàng và các phát hiện khác của bệnh nhân. Vui lòng sử dụng các phương pháp khác nếu kết quả bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào.

12. BẢO QUẢN, SỬ DỤNG VÀ THAI BỎ**Cầm nắm**

- Mẫu bệnh phẩm có nguy cơ chứa các tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm như HIV, HBV, HCV. Vui lòng đeo găng tay và kính bảo hộ khi cầm nắm.
- Nếu thuốc thử rây vào mắt, da hay mắt phải, rửa sạch với thật nhiều nước và liên hệ bác sĩ nếu cần thiết.
- Nếu thuốc thử bị đổ, xả với thật nhiều nước và lau sạch. Nếu mẫu phẩm bị đổ, xử lý phần chất lỏng với cồn 80% và lau sạch bằng khăn giấy.

Sử dụng

- Bảo quản thuốc thử dưới điều kiện chỉ định. Không sử dụng thuốc thử hết hạn.

- Không tái sử dụng chai lọ và dụng cụ phụ trợ của bộ thuốc thử cho mục đích khác.
- Không trộn lẫn thuốc thử khác lô sản xuất.
- Không thêm thuốc thử mới vào thuốc thử đang sử dụng bắt kè lô sản xuất.

Thai bỏ

1. Tất cả các mẫu bệnh phẩm cũng như dụng cụ (ví dụ ống lấy mẫu) phải được xử lý theo sổ tay hướng dẫn sử dụng với dụng cụ y tế tại cơ sở hoặc xử lý theo các cách sau:

- Hấp ướt trong autoclave ở nhiệt độ 121°C trong hơn 20 phút. Không xử lý hấp ướt với sản phẩm có chứa natri hypoclorit còn dư.
- Ngâm trong dung dịch nước Javen ít nhất 1 giờ (nồng độ clo hoạt động tối thiểu 1000ppm).

2. Thuốc thử có chứa Natri Azit 0.05% làm chất bảo quản. Natri Azit có thể phản ứng với chì hoặc đồng tạo thành vật liệu có tính nổ cao. Khi thái bỏ nên tiến hành với lượng lớn nước.

13. THÔNG SỐ CÀI ĐẶT CHO MÁY TỰ ĐỘNG**❖ Cho dòng máy Hitachi**

Phương pháp tính toán	Đo 2 điểm	
Nhiệt độ	37°C	
Mẫu	2.4	
Thể tích (µL)	R1	120
	R2	120
Bước Sóng (nm)	Chính	570
	Phụ	800
Điểm 1	10	
Điểm đo (chu kỳ)	Điểm 2	19
	Điểm 3	34
Dạng đường chuẩn	Spline	
Đơn vị	mg/dL	

14. HƯỚNG DẪN VÀ CẢNH BÁO KHÁC

- Kết quả có thể thay đổi tùy thuộc vào tỉ lệ mẫu/thuốc thử. Liên hệ với kỹ sư vận hành để điều chỉnh thông số cài đặt cho các dòng máy khác nhau.

- Tiến hành hiệu chuẩn hàng ngày trước khi xét nghiệm.

15. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

TEL: 047-710-4871 (dial-in)

FAX: 047-710-4872

Mã SP	Đóng gói	Test/Kit*	Test/Kit**
11C014A	1x60mL; 1x60mL	356	540
11C014A2	2x60mL; 2x60mL	712	1080
11C014A3	3x60mL; 3x60mL	1068	1620
11C024A	4x60mL; 4x60mL	1424	2160
11C014A5	5x60mL; 5x60mL	1780	2700
11C014A6	6x60mL; 6x60mL	2136	3240
11C014	1x90mL; 1x90mL	530	810
11C014-2	2x90mL; 2x90mL	1060	1620
11C024	3x90mL; 3x90mL	1590	2430
11C014-4	4x90mL; 4x90mL	2120	3240
11C014-5	5x90mL; 5x90mL	2650	4050

* Dành cho máy tự động công suất trung bình: SK300; BS series; BA200; BA400. Chemwell Series; Dirui Series; Biolyzer series, HumanStar 300, Erba Series; Bioelab Series, BX 3010; Pictus P500;....

** Dành cho máy tự động công suất lớn: CA800; CA400; Randox Imola; Randox Modena+; BM 6010; Biolis50i; SK500; AU Series; Pictus P700; C series; Ci series; HumanStar 600; Kenolab series

Số lượng test được đề cập bên trên được tính toán dựa trên thông số kỹ thuật của mỗi thiết bị. Số liệu thực tế có thể cao hơn tính toán.

Số lượng test được đề cập bên trên đã gồm sự hao hụt do thể tích chênh của lọ hóa chất nhung chưa bao gồm sự hao hụt cho chất chuẩn và chất hiệu chỉnh.

Để nhận thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với các đại lý phân phối được ủy quyền.

16. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- P.J.H. Jones, T.C. Rideout, in Comprehensive Biotechnology (Third Edition), 2011
- CLSI/NCCLS Evaluation of Precision Performance of Clinical Chemistry Devices, EP05-A2, 2004
- CLSI EP17 · Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures, 2nd Edition, 2017
- Tài liệu nội bộ, UMA Diagnostics

17. NHÀ SẢN XUẤT

UMA Co., Ltd.

2-19-6 Yokosuka, Matsudo City, Chiba

Prefecture 270-0031